

Název veřejné zakázky	Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu – polohovatelné postele
Datum zahájení řízení	23.04.2024
	P24V00000439/Z2024-017991

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 doručené dne 16.05.2024

Dotaz č. 1

Parametr – 4dílná ložná plocha lůžka – odnímatelná síť

Může uchazeč zadavateli nabídnout 4dílnou ložnou plochu z pevných, neodnímatelných, kovových lamel.

Domníváme se, že ložná plocha z kovových lamel je pevnější, lépe čistitelná a disponuje vyšší stálostí.

Odpověď

ANO, může být i z kovových lamel, pokud budou zachovány všechny funkce polohování

Dotaz č. 2

Parametr – ruční ovladač s magnetickým zámkem

Může uchazeč zadavateli nabídnout ruční ovladač s mechanickým zámkem?

Jedná se o jiné konstrukční řešení uchazeče, který nemá žádný vliv na medicínský účel lůžka.

Odpověď

NE, zadavatel trvá na ručním ovladači s magnetickým zámkem.

Dotaz č. 3

Parametr – rozměr ložné plochy 200x86cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout rozměr ložné plochy 200x90cm?

Domníváme se, že se jedná o vyšší komfort pro pacienta při zachování vnějších rozměrů lůžka (206 x 103 cm).

Odpověď


Zadavatel připouští shora uvedené za podmínky, že rozměr matrace bude odpovídat rozměru ložné plochy

Dotaz č. 4

Parametr – průběžné dvoudílné postranice (funkčnost postranic dle zobrazeného referenčního výrobku, tj. možnost nezávisle sklopit pouze 1 část postranice)

Může uchazeč zadavateli nabídnout integrované, dělené (vodorovně) postranice se zámkem proti nechtěnému sklopení, kde může zadavatel sklopit pravou nebo levou část postranice (do šikma)?

Obrázek přikládáme do přílohy

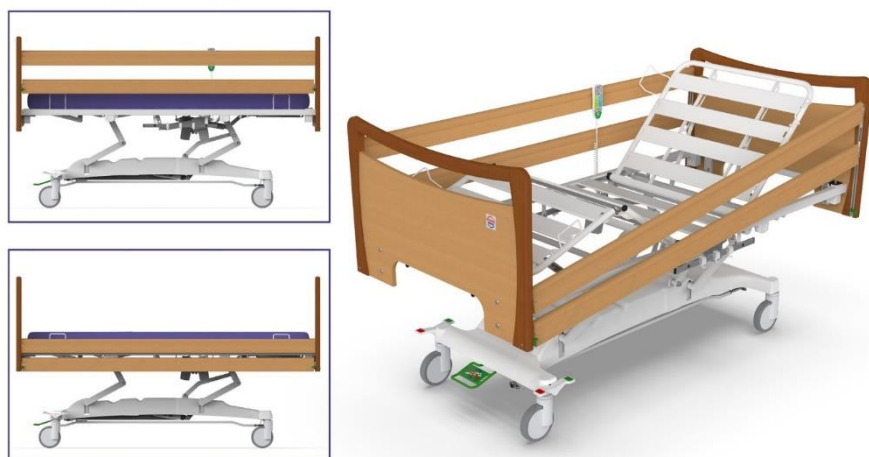

Odpověď

Zadavatel požaduje lůžka s postranicemi, které musí být dělené (tedy svisle rozdělené na dvě samostatně fungující části), viz přiložený obrázek.

V žádném případě se nesmí jednat o postranice průběžné dvoudílné, či dělené vodorovně!!



Dne 21.05.2024

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ